

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

■実施日 平成 22 年 4 月 1 日（木）ご依頼分より

■変更項目

検査項目	IL-5(インターロイキン-5)
------	------------------

●変更一覧表


案内書掲載頁	項目コード No.	検査項目	変更箇所	新	現	備考
171	21777	IL-5 (インターロイキン-5)	検体量	血清 0.5 mL	血清 1.0 mL	現試薬の改良試薬への変更に伴う検体量および基準値（参考値）の変更。
			基準値	3.9 pg/mL 以下 (参考値)	7.8 pg/mL 以下 (参考値)	

● IL-5 (インターロイキン-5)

本検査におきまして、試薬メーカーにより検体量の少量化、感度の向上、プロトコルの簡易化がはかられた改良試薬へ変更させていただきます。あわせて、基準値（参考値）を変更させていただきます。なお、新参考値は、メーカー設定値（測定下限値以下）です。

項目コード No.	検査項目	変更箇所	新	現
21777	IL-5 (インターロイキン-5)	検体量	血清 0.5 mL	血清 1.0 mL
		基準値	3.9 pg/mL 以下 (参考値)	7.8 pg/mL 以下 (参考値)

▼現試薬と新試薬の比較

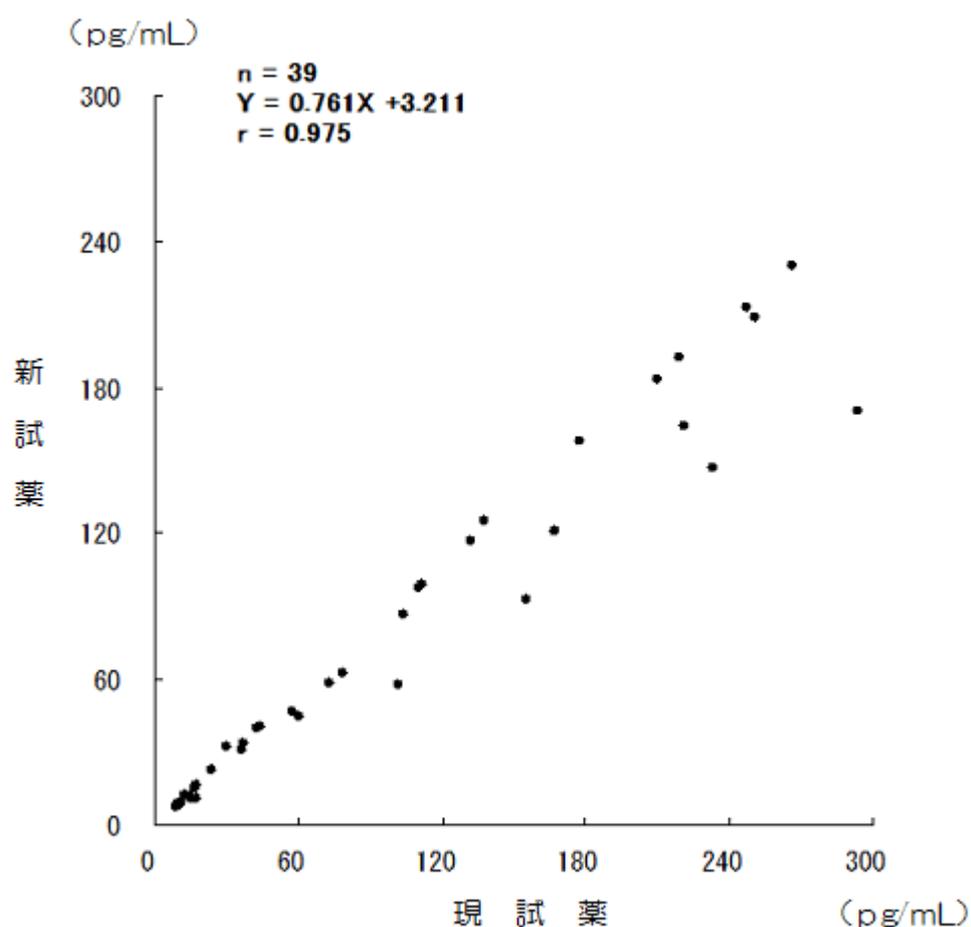

▼変更後の検査内容一覧

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値 (単位)	備考
21777 (5J110)	IL-5 (インターロイキン-5)	血清 0.5	↓ X	絶対凍	事前に 確認 ください		ELISA	3.9 以下 (参考値) (pg/mL)	